


Anatomisk information i PA-mall


Lägg in anatomisk info på bilder i DentalEye


- När denna ruta kommer upp står det att man ska välja anatomisk information för bilden under "Egenskaper".

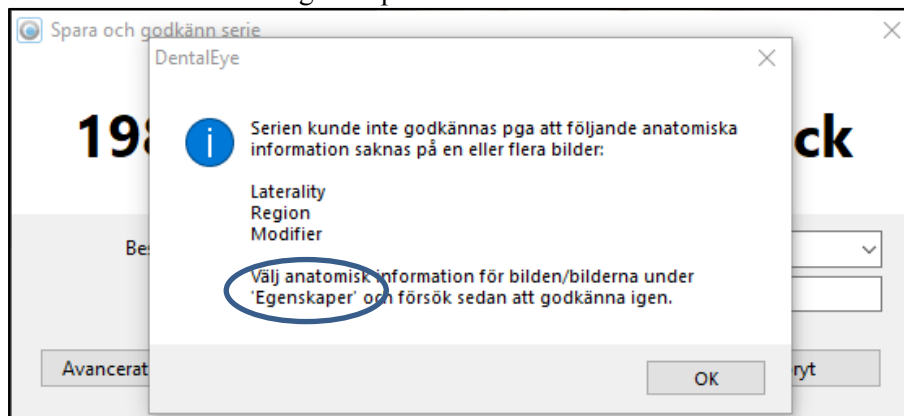

- När bild är markerad och man klickar på **INGEN** vid "Beskrivning" under Egenskaper så skapas en ruta

Egenskaper	
Objekt	
Bildtyp	Intraoral röntgen (IC)
Datum	2019-11-11 15:15 ...
Beställare	tvevagon
UID	1.2.840.114257.3.6.4
Anatomisk information	
Beskrivning	INGEN
Laterality	Okänd
Region	Okänd
Modifier	Okänd
Exponering	
Föreg. exp	2019-09-23 16:10 ...
Spänning (kV)	0
Strömstyrka (mA)	0
Exponeringstid (r)	0
Röntgengdos i mSv	0
Serie	
Bildnummer	1
Bildrutans numr	1


- Klicka på  och en vallista kommer fram.
Här kan man sedan direkt välja rätt anatomisk information.

Egenskaper	
Objekt	
Bildtyp	Intraoral röntgen (IC)
Datum	2019-11-11 15:15 ...
Beställare	tvevaron
UID	1.2.840.114257.3.6.4
Anatomisk information	
Beskrivning	INGEN 
Lateralitet	Molar höger ök
Region	Premolar höger ök
Modifier	Canin höger ök
Exponering	Framtänder höger ök
Föreg. exp	Framtänder ök
Spänning	Framtänder vänster ök
Strömstyrka	Canin vänster ök
Exponeringstid	Premolar vänster ök
Röntgengdos i mSv	Molar vänster ök
Serie	Molar vänster uk
Bildnummer	
Bildrutans numr	1

Vilket då ger rätt anatomisk information på tanden

Egenskaper	
Objekt	
Bildtyp	Intraoral röntgen (IC)
Datum	2019-11-11 15:15 ...
Beställare	tvevaron
UID	1.2.840.114257.3.6.4
Anatomisk information	
Beskrivning	Molar höger ök
Lateralitet	Höger
Region	Maxilla
Modifier	Molar 3
Exponering	
Föreg. exp	2019-09-23 16:10 ...
Spänning (kV)	0
Strömstyrka (mA)	0
Exponeringstid (t)	0
Röntgengdos i mSv	0
Serie	
Bildnummer	1
Bildrutans numr	1

- Man kan även som tidigare gå via  som ger denna ruta och lägga till anatomisk beskrivning.

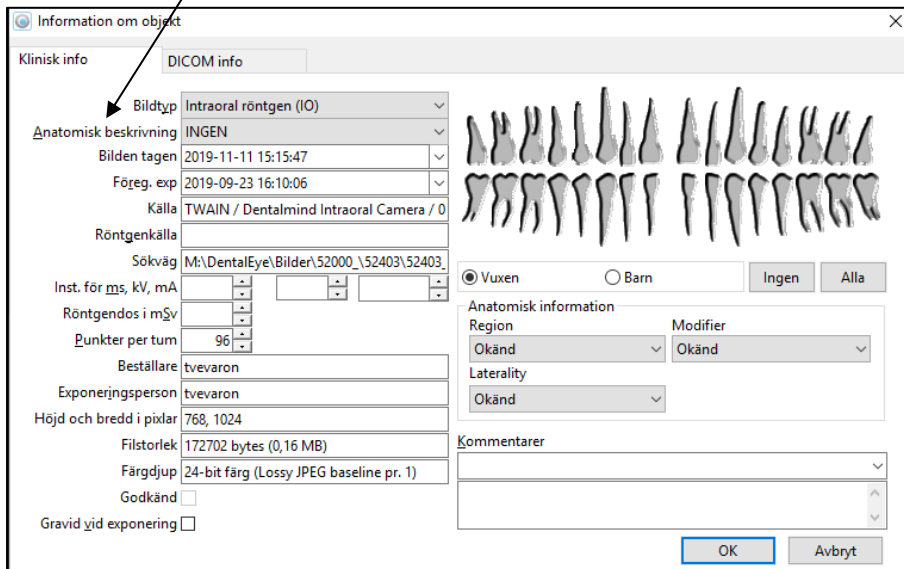

Information om objekt

Klinisk info | DICOM info

Bildtyp: Intraoral röntgen (IO)

Anatomisk beskrivning: INGEN

Bilden tagen: 2019-11-11 15:15:47

Föreg. exp: 2019-09-23 16:10:06

Källa: TWAIN / Dentalmind Intraoral Camera / 0

Röntgenkälla:

Sökväg: M:\DentalEye\Bilder\52000_\52403\52403

Inst. för mS, kV, mA: . . .

Röntgendos i mSv: . . .

Punkter per tum: 96

Beställare: tvevaron

Exponeringsperson: tvevaron

Höjd och bredd i pixlar: 768, 1024

Filstorlek: 172702 bytes (0,16 MB)

Färgdjup: 24-bit färg (Lossy JPEG baseline pr. 1)

Godkänd:

Gravid vid exponering:

Anatomisk information


Region: Okänd | Modifier: Okänd

Laterality: Okänd

Kommentarer:

OK | Avbryt

Det går nu att godkänna bilden. Glöm inte att skriva in beskrivning av bilden, tex. 15, 25 apikal

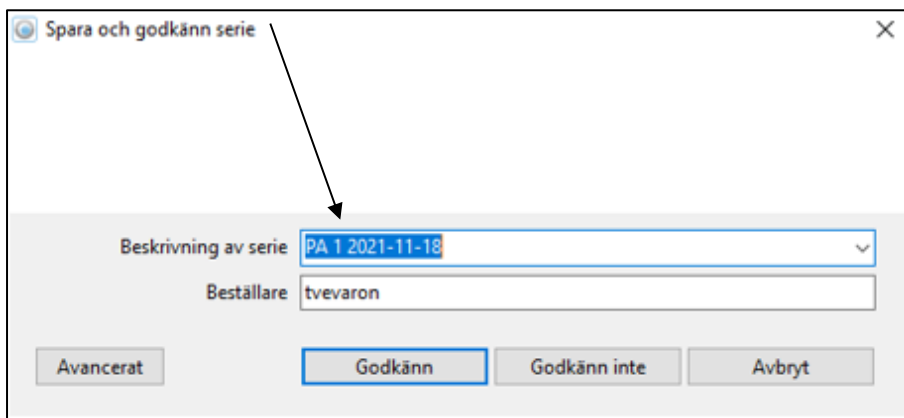

Spara och godkänn serie

Beskrivning av serie: PA 1 2021-11-18

Beställare: tvevaron

Avancerat | Godkänn | Godkänn inte | Avbryt